



บันทึกข้อความ

077/bA
๒๕๓๖/๒๕๓๗

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม ๐๕๖-๕๑๑๐๘๑ ต่อ ๓๒๐

ที่ ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/๑๐๙๔๔

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง	บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๔๐๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลอุทัยธานีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางบุณชรีกร พันธ์ธรรม)

เจ้าหน้าที่

(นายจิรวัดน์ เชี่ยวชาญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้มีโครงการ ซื้อมอเตอร์ตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

มอเตอร์ตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด (ขาย
ปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๖๖/๑๓-๑๔ ถนนพระราม ๔
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๙-๑๙๘๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๒๐๐๘๓๒๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๗๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ที่อยู่ ๕๖ ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๒๔๔๕๖

ตามที่ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กล้องส่องตรวจท่อไต	๑	เครื่อง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๓๗๓,๘๓๓.๗๘
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๖,๑๖๘.๒๒
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนบาทถ้วน)					

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลอุทัยธานี ๕๖ ถนนรักการดี
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๐๑๕๒๗๗ ชื่อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายจิรวัดน์ เชี่ยวชาญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๐๑๕๒๗๗

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๔๐๑๓๔๗๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม

ที่ อนุ ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/๑๐๒๖๕

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วย โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมมีความประสงค์จะ ซื้อมอเตอร์สำรองท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และการบริหารงานในโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ซื้อมอเตอร์สำรองท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากเงินประกันสังคมพัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายเผด็จ แก้วจงประสิทธิ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๒. นางจริยา บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. นายนาวัน สมอบ้าน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการโรงพยาบาลอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางบุณศรีกรร พันธ์ธรรม)

เจ้าหน้าที่

(นายจิรวุฒิ เชี่ยวชาญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุรชัย โชคครชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นายจิรวุฒน์	เชี่ยวชาญ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางบุญศรี	พันธุกรรม	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นายเผด็จ	แก้วจงประสิทธิ์	(ประธานกรรมการ)
ข้าพเจ้า นางจริยา	บุญฤทธิ	(กรรมการ)
ข้าพเจ้า นายนาวิน	สมอบ้าน	(กรรมการและเลขานุการ)

ขอให้การรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(นายจิรวุฒน์ เชี่ยวชาญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม
(นางบุญศรี พันธุกรรม)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม
(นายเผด็จ แก้วจงประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นางจริยา บุญฤทธิ)
กรรมการ

ลงนาม
(นายนาวิน สมอบ้าน)
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ
นี้ได้โดยอนุโลม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี งานครุภัณฑ์การแพทย์ โทร. ๐๕๖-๕๑๑-๐๘๑ ต่อ ๓๒๐

ที่ ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/ ๑๐๖๖๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
กล้องส่องตรวจท่อไต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยโรงพยาบาลอุทัยธานี มีความประสงค์จะจัดกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ด้วยเงินเงินประกันสังคมพัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคา
กลาง ประกอบด้วยข้าราชการดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายเผดิม | แก้วจงประสิทธิ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางจรรยา | บุญฤทธิ์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นายนาวิน | สมอบ้าน | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งฯ ทั้งนี้เป็นอำนาจของ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นางบุณชรีภา พันธุ์ธรรม)

เจ้าหน้าที่

(นายจิรวัดน์ เชี่ยวชาญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ-ลงนามแล้ว

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๑๖๗/๕/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
กล้องส่องตรวจท่อไต่

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ด้วยเงินประกันสังคมพัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วยข้าราชการดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายเผดิม แก้วจงประสิทธิ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางจรียา บุญฤทธิ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (๓) นายนาวิน สมอบ้าน | ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑ ต่อ ๓๒๐

ที่ อนุ ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/๑๐๗๗๕ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

กล้องส่องตรวจท่อไต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเดิม

๑. โรงพยาบาลอุทัยธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ด้วยเงินประกันสังคมพัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี นั้น

๒. ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๑๖๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง ดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๒ แผ่น
๒. ราคากลางกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. โดยใช้ราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม ปีพ.ศ.๒๕๖๑

ข้อระเบียบ


๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ ในการจัดซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

๒. ผู้ว่าราชการ...

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีในการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามหนังสือคำสั่งที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเพติม แก้วจงประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจริยา บุญฤทธิ์)


(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายนาวิน สมอบ้าน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลอุทัยธานี พิจารณาแล้วเห็นควรใช้คุณลักษณะและกำหนดราคาตามมติ คณะกรรมการกำหนดในอัตรางเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป


(นางบุญทริกา พันธุ์ธรรม)
เจ้าหน้าที่


(นายจिरวัฒน์ เชี่ยวชาญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นายสุรชัย โชคกรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

คุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจท่อไต
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ กล้องส่องตรวจท่อไต มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่องตรวจท่อไต

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑. กล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต (Uretero-Renoscope)

- ส่วนปลายของกล้องเป็นชนิดไม่มีคม
- ปลอกนอกมีขนาดเล็ก
- มีช่องน้ำเข้า พร้อมด้วยวาล์วน้ำด้านขวาและซ้าย
- เลนส์ตามองภาพทำมุมเอียงกับลำกล้อง
- ขนาดส่วนปลายขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Fr.
- ปลอกนอกเป็นทรงเรียวขยาย
- ขนาดของช่องใส่เครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า ๕ Fr.
- เลนส์ตา (eyepiece) เป็นแบบทำมุมเอียงกับตัวกล้อง (angled)

๓.๒. เครื่องมือคิบบ้างเนื้อเยื่อและชิ้นส่วนนี้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑. กล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต (Uretero-Renoscope) จำนวน ๑ ชุด

- ส่วนปลายของกล้อง (distal end) เป็นชนิดไม่มีคม (atraumatically) ส่วนปลายมน (rounded tip)
- ปลอกนอกมีขนาดเล็ก (minimal sheath diameter)
- มีช่องน้ำเข้าขนาดใหญ่ (large working channel) พร้อมด้วยวาล์วน้ำด้านขวาและซ้าย (๒ lateral)
- เลนส์ตามองภาพ (eyepiece) ทำมุมเอียงกับลำกล้อง (angled) เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

(more comfortable) และจับถือได้ง่าย (easy handling)

- ขนาดส่วนปลาย (distal tip) ขนาดไม่มากกว่า ๔ Fr.
- ปลอกนอก (instrument sheath) มีขนาด ๘ Fr. และเป็นทรงเรียวขยายขนาด ๑ step

ซึ่งจะขยายขนาดไปถึงส่วนโคนให้มีขนาด ๑๓.๕ Fr.

- ขนาดของช่องใส่เครื่องมือ (central working channel) ขนาด ๕ Fr. สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องมือขนาด ๔ Fr.

- ส่วนปลายเลนส์ (telescope) มีทิศทางมองภาพที่ ๖ องศา
- ความยาวใช้งาน (length) ๔๓ เซนติเมตร
- เลนส์ตา (eyepiece) เป็นแบบทำมุมเอียงกับตัวกล้อง (angled)
- สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclavable)

๔.๒. เครื่องมือคิบบ้างเนื้อเยื่อและชิ้นส่วนนี้มีความยาว ๖๐ เซนติเมตร ขนาดเครื่องมือ ๔ เอฟอาร์ ปลายปากขยับได้ทั้งสองด้าน จำนวน ๒ ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๓ ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งช่างมาตรวจและทำการบำรุงรักษาทุก ๔ เดือน เพื่อให้สภาพพร้อมใช้งานเสมอ

๕.๔ ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการชำรุดขัดข้องเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีนำเครื่องมือกลับไปซ่อม ผู้ขายต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ขณะซ่อม หากเกินกว่า ๓๐ วันแล้ว ผู้ขายยังไม่สามารถซ่อมได้จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๕ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดอุทัยธานี ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงจะเรียกผู้ขายมาทำสัญญาซื้อขายต่อไป



(นายเพติม แก้วจงประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ



(นางจิริยา บุญฤทธิ์)
กรรมการ



(นายนาวิน สมอบ้าน)
กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี

ที่ อนุ.๐๐๓๒.๒๐๒.๕/๒๗๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอดำเนินการขอจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

เนื่องด้วยงานห้องผ่าตัดมีความจำเป็นต้องขอจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการดังนี้

๑. ชุดส่องตรวจทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

จำนวน ๑ ชุดราคา ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ (หัวprobeชนิดใส่ในrectum)

จำนวน ๑ ชุดราคา ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท

๓. กล้องส่องตรวจท่อไต

จำนวน ๑ ชุดราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ด้ามเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด

จำนวน ๑ ชุดราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท

โดยมติจากที่ประชุมประกันสังคมให้ใช้งบประมาณพัฒนาโรงพยาบาลในการจัดซื้อ

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

(นางจรรยา บุญฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานห้องผ่าตัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดขัง

เห็นควรแจ้ง

(นายพรชัย หาญดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายไพโรจน์ พบประเสริฐ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร



อัครลักษณ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี

ทิวส์ตย์ บริการดี ทั่วหัวใจ

(นางน้อมจิต จันทร์น้อย)

หัวหน้าพยาบาล

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๑ ๗๐ ๓ ๗๖๖

๑๗๖๖ ๓๗๖๕๖๖
๑๑๗ ๕ ๗๖๗๗

๒ นางรณานทร

ประยูร

๓

(นายสุรชัย ไชยศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

รายการจัดหาคำสั่งซื้อ ตามงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	เครื่องมือ	ราคา	จำนวน	รวมเงิน
1/	ชุดส่องตรวจทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ	280,000	1	280,000
2/	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ (และหัว probe ชนิดใส่ใน rectum)	1,820,000	1	1,820,000
3/	กล้องส่องตรวจท่อไต	400,000	1	400,000
4/	ค้ำเครื่องมือผ่าตัดไซนัสไปโพรงจมูกด้วยระบบ คัด บั่น ดุด	650,000	1	650,000
5	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	1,500,000	1	1,500,000
6 X	อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ใช้ระบบรีไซเคิล (4103ยว)	50,000	5	250,000
7	ตู้แรงดันลบ (Negative pressure chamber)	43,000	2	86,000
8 X	High Flow (ใช้ระบบรีไซเคิล (4103ยว))	250,000	4	1,000,000
9 /	Microbilirubin	135,000	1	135,000
	รวม		17	6,121,000



บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด

3388/13-14 ถนนพระรามที่ 4 (หลังตึกบิโรรม) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2249-1988-7, 0-2249-1938 Fax : 0-2249-5403

ผู้แทนจำหน่าย : เครื่องมือแพทย์ **Karl Storz, GERMANY**

อพ/พย/uro เสนอราคาเลขที่ A1321-64

เรื่อง เสนอราคา ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต(Lens URS 8.0 set)

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

บริษัทฯ มีความยินดีใ้ใคร่ขอเรียนเสนอราคา ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต(Lens URS 8.0 set)

มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา ดังรายการดังนี้คือ-

1) 1 Pcs. 27001LK	Uretero-Renoscope, 8 Fr., 43 cm	Tcs.	383,300.00
2) 2 Pcs. 27424F	Forceps, 4 Fr., 60 cm	@	32,800.00
	ราคาสินค้า	Tcs.	448,900.00
	ลดพิเศษ	Tcs.	75,068.22
	คงเหลือ	Tcs.	373,831.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	Tcs.	26,168.22
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	Tcs.	400,000.00

ผลิตภัณฑ์

ของโรงงาน KARL STORZ ประเทศเยอรมันนี

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ราคา

ยี่นราคาอยู่ได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564

กำหนดส่งของ

ส่งของได้ภายใน 120 วัน นับแต่วันได้รับใบสั่งซื้อ

กำหนดชำระเงิน

ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า

ผู้เสนอราคา

คุณ อนันตพงษ์ กันธิยะวงษ์ โทร 086-6197054

E-mail บริษัท

salesadmin@kosinmedicalsupply.com

ทั้งนี้จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ ยงยศันธร)

กรรมการผู้จัดการ

KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

Head Office : 3366/13-14 Soi Manom, Rama 4 Road, King Tan, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand. Chiangmai Branch : 414/12-13 Chang-Kian Road, Amphur Muang, Changmai 50100.

Hatyai Branch : 377 Supasarn-Rangsarn Road, Amphur Hatyai, Songkila 90110. Khonkean Branch : 668/86 Klang-Muang Road, Amphur Muang, Khonkean 40000.

รายละเอียดชุดกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องมือบังคับใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ (Working Element) สำหรับใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะและปลอกนอก ขนาด 21 เอฟอาร์
2. ปลอกนอกสำหรับกรีดท่อปัสสาวะ (Urethrotome Sheath) ขนาด 21 เอฟอาร์
3. แกนกลาง (Obturator) สำหรับใช้ร่วมกับปลอกนอกในข้อ 2
4. ข้อต่อเชื่อมกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ (Telescope Bridge) ขนาด 5 เอฟอาร์ มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือ
5. ปลอกเสริม (Supplementary Sheath) เปิดด้านข้าง (Sides Open) มีไว้ช่วยใส่สายสวนแบบ Balloon
6. ปลอกเสริม (Supplementary Sheath) สำหรับจ่ายหรือดูดของเหลว (continuous irrigation and suction)
7. ใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ ส่วนปลายรูปทรงตรง (Knife, straight)
8. ใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ ส่วนปลายรูปทรงตะขอ (Cold Knife, hook-shaped)
9. ใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ ส่วนปลายรูปทรงกลม (Knife, round)
10. ใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ ส่วนปลายรูปทรงตรง แต่ส่วนคมเป็นรูปแบบคลื่น (Knife, straight, wavy edge)
11. ใบมีดกรีดท่อปัสสาวะ ส่วนปลายรูปทรงวงแหวน (Cold Knife, ring-shaped)
12. กระจกสำหรับเก็บใบมีดกรีดท่อปัสสาวะเพื่อเก็บรักษาและเพื่อส่งทำปลอดเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
- 1.2 ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งช่างมาตรวจและทำการบำรุงรักษาทุก 4 เดือน เพื่อให้สภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- 1.3 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด ในวันส่งมอบ
- 1.4 เป็นเครื่องมือใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 1.5 ผู้ขายต้องฝึกอบรมสาธิตวิธีการใช้ วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้จริง ก่อนการส่งมอบ ณ วันที่ตรวจรับพัสดุ
- 1.6 ในระยะเวลาประกัน หากเกิดการชำรุดขัดข้องเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีนำเครื่องมือกลับไปซ่อม ผู้ขายต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ขณะซ่อม หากเกินกว่า 30 วันแล้ว ผู้ขายยังไม่สามารถซ่อมได้จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ภายใน 30 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ



SIAMWORKTECHNOLOGY

บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด

538/1 ซ. น. โทรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร : 062-019-2225, 02-002-5071

Website : www.siamworktechnology.com

E-mail : manager@siamworktechnology.com

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561010891


เริ่ม/Attention: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่อยู่ : เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000 เสนอราคา ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต (Lens URS 8.0 set) บริษัท สยามเวิร์คเทคโนโลยี จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้ We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :	เลขที่/ No. : SW141/64C
	วันที่ Date : 7 พ.ค. 64
	ยื่นราคา 60 วัน ชำระเงินภายใน 30 วัน หลังส่งมอบ ส่งของภายใน 120 วันหลังได้รับใบสั่งซื้อ

ลำดับ ITEM	รหัสสินค้า CODE	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน Quantity	ราคาต่อชิ้น Price/Day	ราคารวม Amount
1		Uretero-Renoscope, 8 Fr., 43 cm	1	398,000.00	398,000.00
2		Forceps, 4 Fr., 60 cm	2	40,000.00	80,000.00
หมายเหตุ : ราคาสินค้ารวมภาษี 7%					

(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ยอดเงินสุทธิ

478,000.00

ผู้อนุมัติ :  **SIAMWORKTECHNOLOGY CO., LTD.**
บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(นางสาวบุศรา ศิริวงศ์)

Sale Admin
โทร. : 062-019-2225
02-002-5071



ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี (GOODWILL TECHNOLOGY LTD., PART.)

538/3 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร (02) 001-6818 แฟกซ์ (02) 001-6818 Email : manager@goodwillthailand.com

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน/Attention: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	เลขที่/ No.	G163-64
	วันที่ Date	7-พ.ค.-64
	ผู้แทนขาย	คุณพิรยา แซ่ลิ้ม
	TEL. :	062-886-7444

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้


We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคาต่อหน่วย Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount	
	ชุดกล้องส่องตรวจท่อไต(Lens URS 8.0 set)	510,000.00	1 ชุด	510,000.00	
1	Uretero-Renoscope, 8 Fr., 43 cm	430,000.00	1 ชิ้น	430,000.00	
2	Forceps, 4 Fr., 60 cm	40,000.00	2 ชิ้น	80,000.00	
	* ราคารวมภาษี 7%				
				ราคาสินค้า	476,635.51
				Vat7%	33,364.49
				รวมทั้งสิ้น	510,000.00

ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา

กำหนดยื่นราคา : 60 วัน
กำหนดส่งของ : 120 วัน
กำหนดชำระเงิน : 30 วัน



ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของดังกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด

นางสาวพิรยา แซ่ลิ้ม (ผู้จัดการ)

Meeting All Requirements

Uretero-Renoscopes, rigid

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Uretero-renaloscopes have long been a core component of the KARL STORZ product range. As standstill is nowadays considered to be synonymous with a lack of progress, KARL STORZ constantly strives to optimize and enhance all instruments.


The new generation of uretero-renaloscopes developed by KARL STORZ presents a further advanced development with an innovative concept and design.

The new sheath design features a considerably softer sheath tip. This ensures excellent guiding properties and so enables simple and atraumatic treatment for the patient. In addition to introducing new elements, tried and tested features were maintained, for example, the

atraumatic sheath tip and the self-closing seal. The HOPKINS® rod lens system and/or the KARL STORZ fiber system continue to provide excellent visualization. Various removable ports with quick-release coupling allow the surgeon individual combinations.

The innovative design concept of the new generation of uretero-renaloscopes provides urologists with vastly improved options in terms of diagnosis and treatment.

With diameters ranging from 7 to 10 mm, as well as working channels from 3.4 to 6 mm, KARL STORZ offers the right instrument for every situation and ensures efficient diagnosis and treatment.

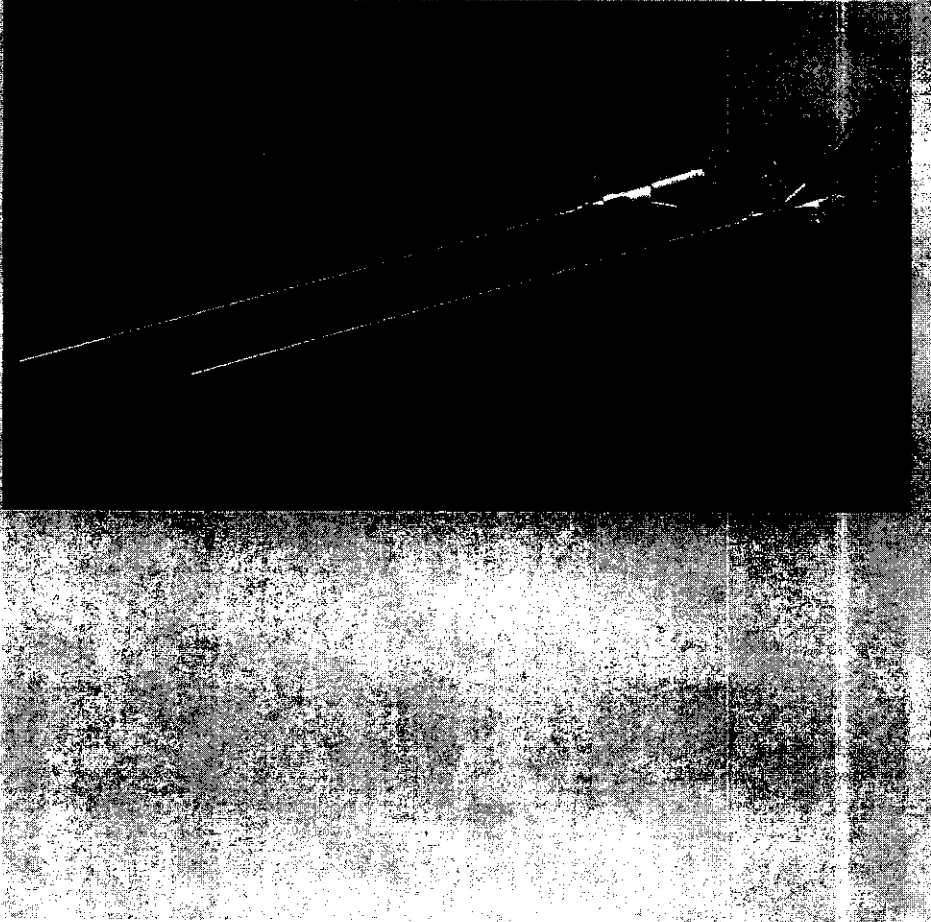


1-06

The Right Solution for each Individual Anatomy and Indication

Uretero-Renoscopes, rigid

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

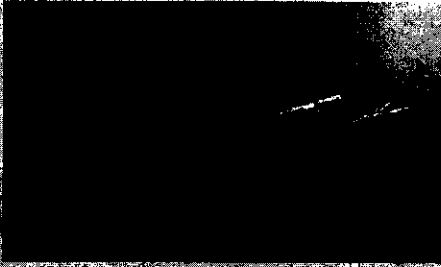


The reduced outer diameter ensures minimal patient discomfort. The unique design combined with the proven KARL STORZ quality guarantees a stable and robust sheath. The new slender design makes work more ergonomic and comfortable for the operating surgeon.



Right-angled irrigation/suction channels prevent positioning instruments too close to the housing, enabling optimal handling and overview introduction. The flow control allows the surgeon support to disperse the inflow of irrigation fluid in critical situations, preventing a splash and fluid washed into the renal pelvis due to irrigation which is too strong or which changes in an uncontrolled manner.



The removable instrument ports are attached to the uretero-renaloscope with a quick-closing mechanism and are available either as single channel or double channel. The dual-closing seal of the instrument KARL STORZ has the only really reliable seal and closes by itself during both dissection and final introduction of instruments without removing the seal.

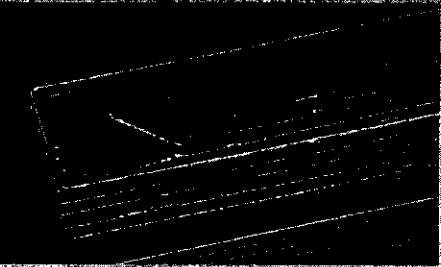

Wire Tray 3950 is a special tray for uretero-renaloscopes during and between operations, for storage and consequently, for transport.

From diagnosis to therapy, from the operation, cleaning, storage, accessories and more, KARL STORZ provides solutions to cover all hospital workflow processes.


1-95

The New Generation

Uretero-Renoscopes, rigid

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE


Which French specifications are important?
You decide!

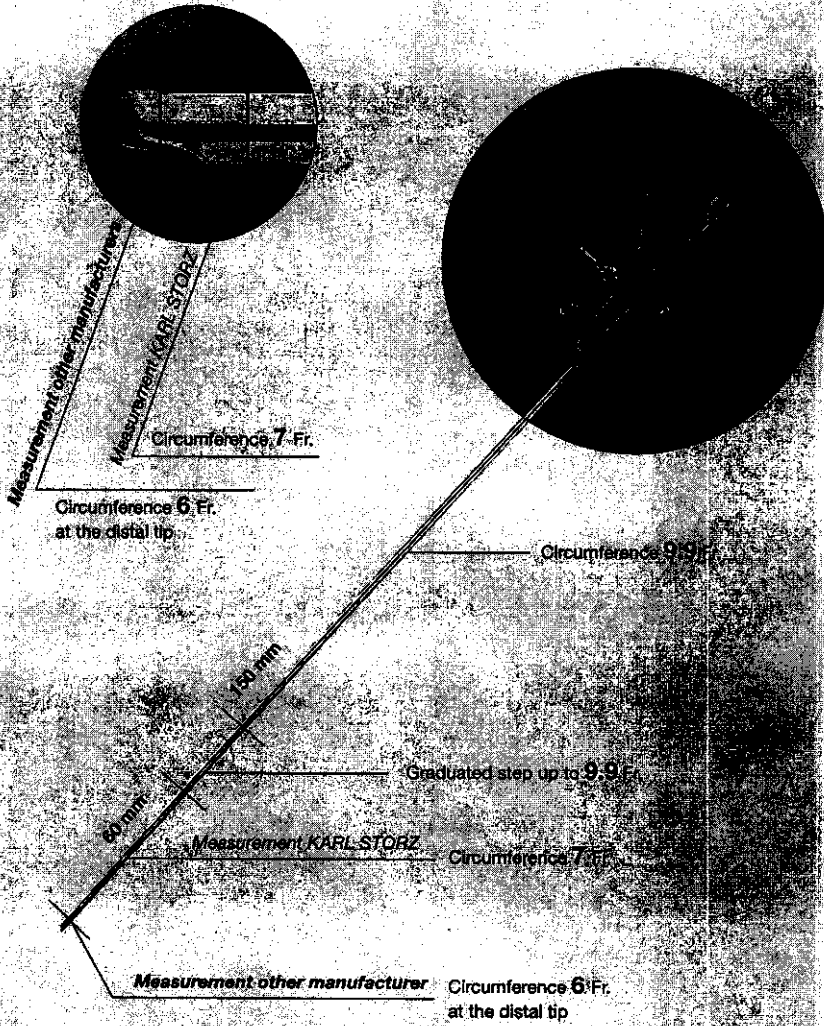

1-06

The New Generation

Uretero-Renoscopes, rigid

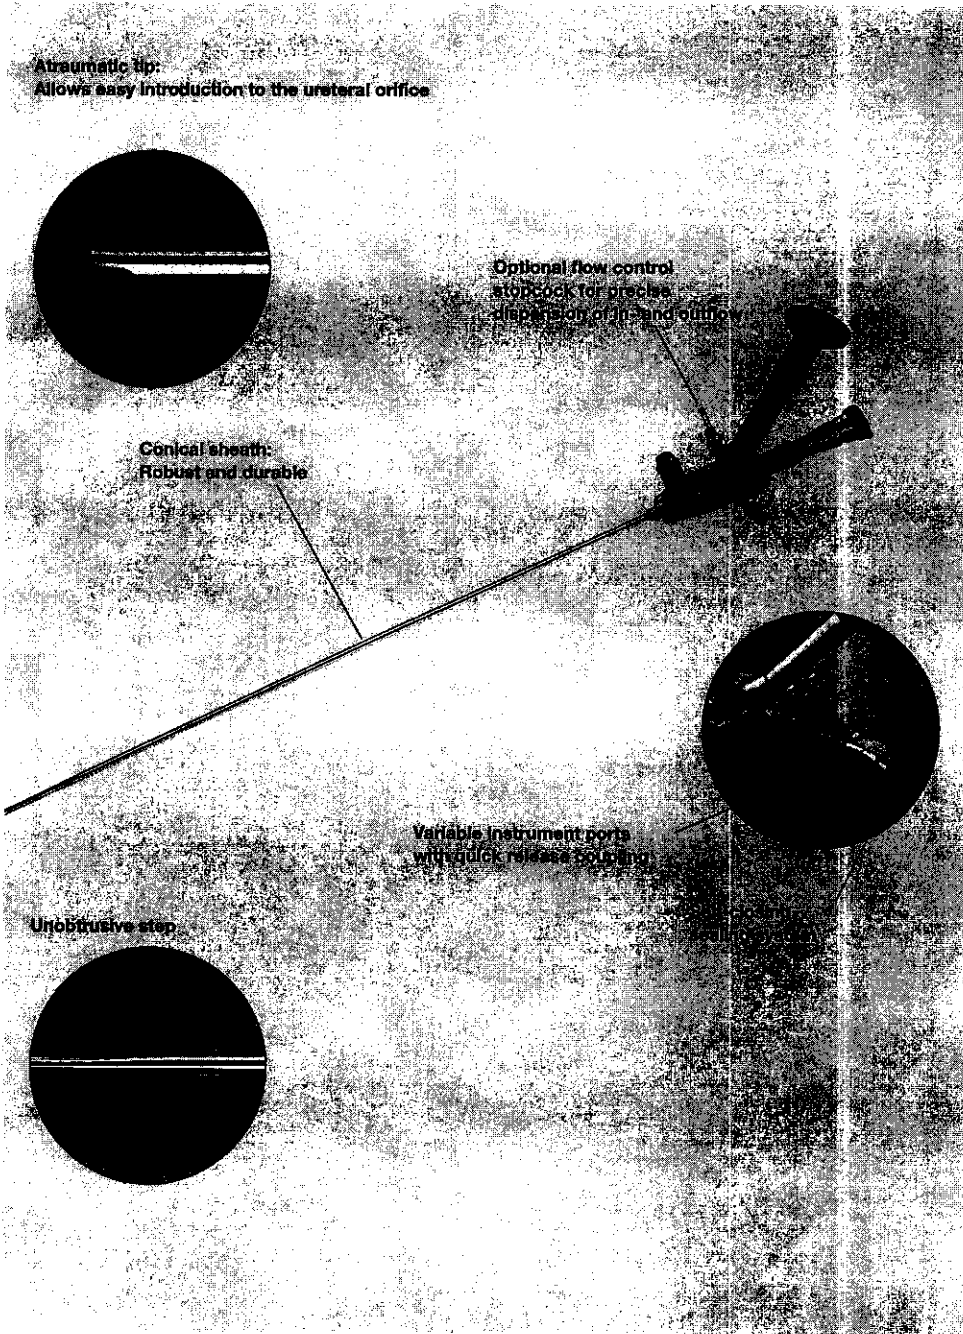

Atraumatic tip:
Allows easy introduction to the ureteral orifice

Optional flow control stopcock for precise dispersion of inflow and outflow

Conical sheath:
Robust and durable

Variable instrument ports with quick release coupling

Unobtrusive step

1-05

Uretero-Renoscope, Ureteroscope

5 Ft. length 15.24 cm



Special Features:

- Distal end of sheath, traumatically shaped, with rounded tip.
- Maximal sheath diameter
- Maximum inflex due to large central working channel with 2 lateral, right angled irrigation ports.
- The large working channel allows the use of rigid instruments and accessories.
- The rigid sheath is made of stainless steel, has a diameter of 1.2 cm and a length of 15.24 cm. It is made of stainless steel and is suitable for the insertion of instruments.

Specifications:

- Distal tip:
- Instrument shaft:
- Working channel:
- Telescope:
- Length:
- Weight:

- 5 Ft. length 15.24 cm
- 3 - 13.5 Ft.
- 5 Ft. for capacity
- Parameters up to 5 Ft.
- KARL STORZ (see photo)
- 4.5 cm diameter
- 1.2 cm diameter
- 15.24 cm

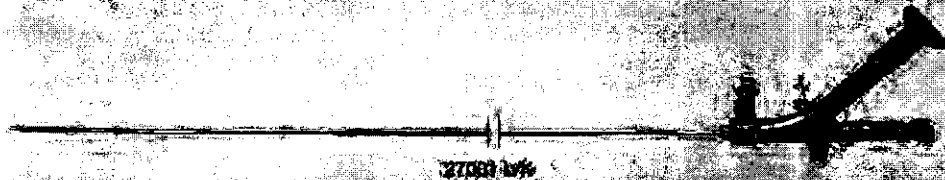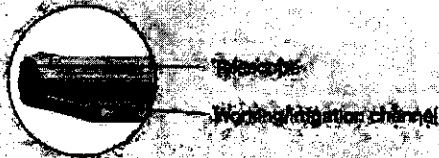

27001 J

Uretero-Renoscope, autoflexible, length 15.24 cm

27001 K








Ureteroscope, autoflexible, length 15.24 cm

Accessories included in delivery or optional accessories see page 152




Accessories for Uretero-Renoscopes and Ureteroscopes

For use with 27001 L/K, 27002 L/K, 27003 L, 27011 L/K and 27013 L.

Following accessories are included:

- | | | |
|---|---------|--|
|  | 27001 E | Insertion Aid, for guide wires in ureterorenoscopy |
|  | 27001 G | Instrument Port with Sealing System and Quick Release Lock, 1.7 mm |
|  | 27500 L | Line Locking Connection, 1.7 mm, for the 27001 G |
|  | 27502 L | Line Locking Connection, 1.7 mm, for the 27001 G |
|  | 27550 N | Seal for working channel, 1.7 mm, for the 27001 G |
|  | 27504 | Flow Control, 6 mm |
|  | 39501 X | Wire Tray, 84 x 150 x 60 mm, including:
27001 BA - Cleaning Kit for Instrument Port 27001 G |

Optional accessories:

- | | | |
|---|----------|--|
|  | 27001 GF | Instrument Port with Sealing System and Quick Release Lock, 1.7 mm |
|  | 27001 GB | Line Locking Connection, 1.7 mm, for the 27001 GF |
|  | 27550 N | Seal for working channel, 1.7 mm, for the 27001 GF |


Instruments for Uretero-Renoscopes and Ureteroscopes

For use with 27001 L/K, 27003 L, 27011 L/K, 27013 L, 27014 L/K



27424 F

Grasping Forceps, for stone fragments, rigid, double action jaws, 4 Fr., length 60 cm, color code: blue



27424 P

Grasping Forceps, for larger stones and fragments, rigid, double action jaws, 4 Fr., length 60 cm, color code: blue



27424 J

Grasping Forceps, rigid, double action jaws, 4 Fr., length 60 cm, color code: blue



27424 R

Grasping Forceps, rigid, double action jaws, 4 Fr., length 60 cm, color code: blue




27424 U

Splitting Forceps, cutting upwards, rigid, single action jaws, 4 Fr., length 60 cm, color code: blue



27023 VC


Stone Basket, rigid, 2.5 Fr., static, disposable



27023 Y

Brush for Cytology, disposable, for single use, 2 Fr., package of 5

For use with 27010 L/K



27024 EB

Grasping Forceps, for stone fragments, rigid, double action jaws, 4 Fr., length 60 cm, for use through both irrigation channels, color code: green



27023 VC

Stone Basket, rigid, 2.5 Fr., static, disposable



27023 Y

Brush for Cytology, disposable, for single use, 2 Fr., package of 5

CALCULASE Laser System for endoscopic treatment of stones in bladder, ureter and kidney
see Chapter 13, UITS



คำสั่ง จังหวัดอุทัยธานี

ที่ ๑๖๔๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ด้วย จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ ซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑
เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเผด็จ แก้วจงประสิทธิ์

ประธานกรรมการฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

๒. นางจริยา บุญฤทธิ์

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๓. นายนาวิน สมอบ้าน

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลอุทัยธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑ ต่อ ๓๒๐

ที่...อน ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/๑๗๑๐๖

วันที่...๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง...รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน...ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจังหวัดได้อนุมัติซื้อกับ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบแล้ว ตามเอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางบุณชรีกา พันธุ์ธรรม)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายจิรวัดน์ เชี่ยวชาญ)

ทราบ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุทัยธานี โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑ ต่อ ๓๒๐

ที่ อน ๐๐๓๒.๒๐๓.๑๙/๑๗๑๐๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้จัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) กับ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ด้วยเงินนอกงบประมาณจากเงิน เงินนอกงบประมาณจากเงินประกันสังคม พัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ได้ส่งมอบส่งของเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยตรวจรับพัสดุตามใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ KS๖๔๑๐๔๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลปรากฏคือผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายทุกประการเห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขายต่อไป

ข้อระเบียบและกฎหมาย

๑ ผู้ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ ๑๗๕ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ตามคำสั่ง จังหวัดอุทัยธานีที่ ๓๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ทุกวิธีรวมถึงการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางบุญทริกา พันธุ์ธรรม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

- โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานการตรวจรับพัสดุตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดณ์ เชี่ยวชาญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเผด็จม แก้วจงประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจริยา บุญฤทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายนาวิน สมอบ้าน)

ทราบ

(นายสุรชัย ไชยครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ตกลงซื้อ
กับ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อมือถือส่งตรวจห่อไต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ


- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเผด็จ แก้วจงประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจริยา บุญฤทธิ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายนาวิน สมอบ้าน)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๐๑๕๒๗๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๖๑๔๐๑๓๔๗๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๘A๑๒๓๕๙๑๓

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD. (HEAD OFFICE)

3366/13-14 หลังอาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. (662) 249-1986-7, 249-1938 แฟกซ์ (662) 249-5403

3366/13-14 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongtan, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand. Tel : (662) 249-1986-7, 249-1938 Fax : (662) 249-5403

KOSIN

Medical Supply Co., Ltd.

เอกสารออกเป็นชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105522008325

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

เลขที่	KS641040
วันที่	3 ส.ค. 2564

ต้นฉบับ
ORIGINAL

เลขที่ลูกค้า 3G012 อัตราภาษีร้อยละ 7 %


ขายให้ โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ. รักษารัตน์ ต. อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

สถานที่ส่ง โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ. รักษารัตน์ ต. อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

อ้างอิงใบสั่งเลขที่	เลขที่ใบสั่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
077/2564	11578/64	พระราม4	พัฒนาเขต			นำส่งโดยผู้แทน	74/อนันตพงษ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	กล้องส่องตรวจท่อไต	เครื่อง	1	400,000.00	400,000.00

Inv.92971009/22.06.21

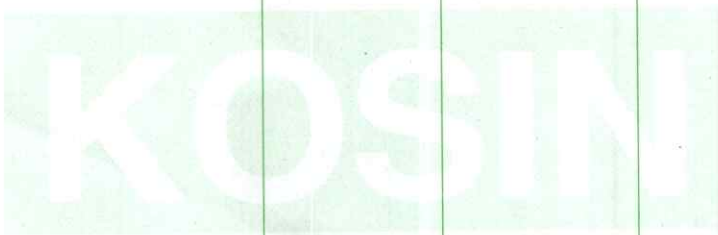

สี่แสนบาทถ้วน	ราคาสินค้า	373,831.78
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,168.22
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	400,000.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ตามยังเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นของพนักงานเก็บเงินพร้อมทั้งลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามและเช็คเรียกเก็บจากธนาคารได้ครบถ้วนแล้ว
ได้รับของตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงนามและประทับตรา ผู้รับของ
วันที่ DATE 3 ส.ค. 2564

ผู้จัดส่ง DELIVERER
วันที่ DATE / /
ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

ในนาม บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
For KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD. (HEAD OFFICE)

3366/13-14 หลังอาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. (662) 249-1988-7, 249-1938 แฟกซ์ (662) 249-5403
3366/13-14 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongtan, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand. Tel : (662) 249-1986-7, 249-1938 Fax : (662) 249-5403

KOSIN

Medical Supply Co., Ltd.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105522008325

ไม่ใช่วินิจฉัยภาษี

เลขที่ลูกค้า 3G012 อัตราภาษีร้อยละ 7 %

ใบแจ้งหนี้
INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด

ใบส่งสินค้า
DELIVERY ORDER

เลขที่	KS641040
วันที่	3 ส.ค. 2564

**ต้นฉบับ
ORIGINAL**

ขายให้ โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ.รักษารัตน์ ต.อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

สถานที่ส่ง โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ.รักษารัตน์ ต.อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

อ้างอิงใบสั่งเลขที่	เลขที่ใบส่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
077/2564	11578/64	พระราม4	พัฒนเขต			นำส่งโดยผู้แทน	74/อนันตพงษ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	กล้องส่องตรวจท่อไต	เครื่อง	1	400,000.00	400,000.00

Inv.92971009/22.06.21

KOSIN

<p>สี่แสนบาทถ้วน</p>	ราคาสินค้า	373,831.78
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,168.22
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	400,000.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ตามยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ได้รับของตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงนามและประทับตรา ผู้รับของ
วันที่ DATE 3/ส.ค. 2564

ผู้จัดส่ง DELIVERER
วันที่ DATE / /
ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

ในนาม บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
For KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.
ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD. (HEAD OFFICE)

3366/13-14 หลังอาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. (662) 249-1986-7, 249-1938 แฟกซ์ (662) 249-5403
3366/13-14 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongtan, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand. Tel : (662) 249-1986-7, 249-1938 Fax : (662) 249-5403

KOSIN

Medical Supply Co., Ltd.

เอกสารออกเป็นชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105522008325

ไม่ใช้ใบกำกับภาษี)

ใบแจ้งหนี้
INVOICE

เลขที่	KS641040
วันที่	3 ส.ค. 2564

สำเนา
COPY

เลขที่ลูกค้า 3G012 อัตราภาษีร้อยละ 7 %

ขายให้ โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ.วิภาวดี ต.อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

สถานที่ส่ง โรงพยาบาล อุทัยธานี
56 ถ.วิภาวดี ต.อุทัยใหม่
อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000

อ้างอิงใบสั่งเลขที่	เลขที่ใบสั่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
077/2564	11578/64	พระราม4	พัฒนาศ			นำส่งโดยผู้แทน	74/อนันตพงษ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	กล้องส่องตรวจท่อไต	เครื่อง	1	400,000.00	400,000.00

KOSIN

* คิว 27424F 1 ชิ้น Price 4 Fr. 60 cm
รวม 3,800

Inv.92971009/22.06.21

ราคาสินค้า	373,831.78
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,168.22
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	400,000.00

สี่แสนบาทถ้วน

สินค้าตามใบสั่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ได้รับของตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ในนาม บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
For KOSIN MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

ลงนามและประทับตรา ผู้รับของ
วันที่ DATE 3 ส.ค. 2564

ผู้นำส่ง DELIVERER
วันที่ DATE / /
ผิด ตก ยกเว้น E & O.E

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature